
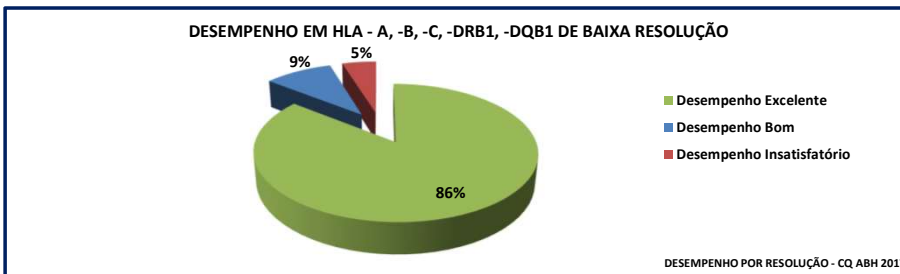





PROGRAMA DE CONTROLE DA QUALIDADE ABH 2017
MODALIDADE I - HLA
DESEMPENHO GERAL POR RESOLUÇÃO

	DESEMPENHO GERAL - BAIXA RESOLUÇÃO	
	HLA - A, -B, -DRB1	HLA - A, -B, -C, -DRB1, -DQB1
Número de Laboratórios Inscritos	3	21
Número de Laboratórios Avaliados	3	21
Desempenho Excelente	3	18
Desempenho Bom	0	2
Desempenho Insatisfatório	0	1

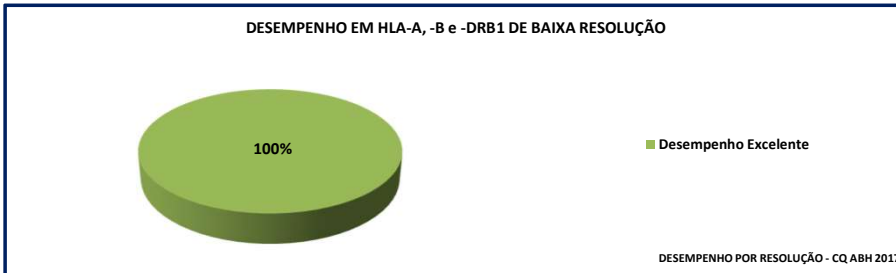

PROGRAMA DE CONTROLE DA QUALIDADE ABH 2017
MODALIDADE I - HLA
DESEMPENHO GERAL POR RESOLUÇÃO

	DESEMPENHO GERAL POR MÉDIA RESOLUÇÃO		
	HLA - A, -B, -DRB1	HLA - A, -B, -DRB1, -DQB1	HLA - A, -B, -C, -DRB1, -DQB1
Número de Laboratórios Inscritos	10	1	34
Número de Laboratórios Avaliados	10	1	34
Desempenho Excelente	8	1	16
Desempenho Bom	1	0	17
Desempenho Insatisfatório	1	0	1

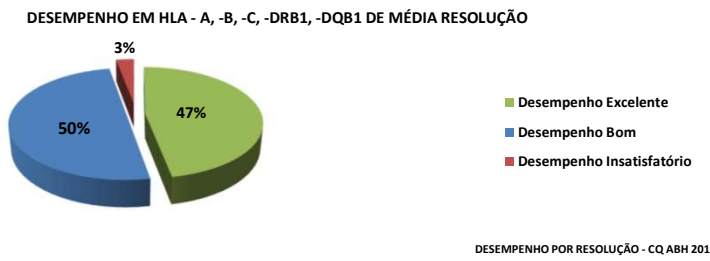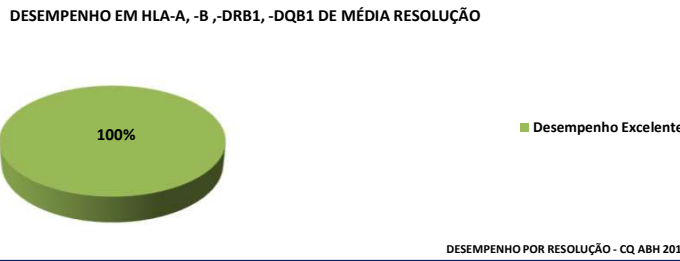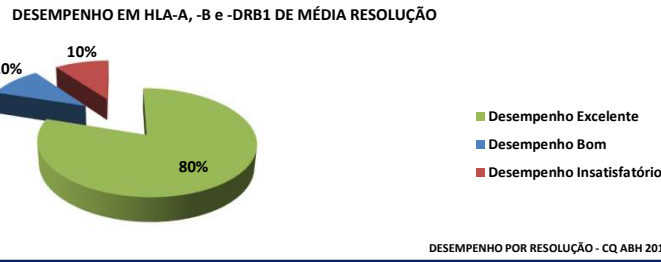

PROGRAMA DE CONTROLE DA QUALIDADE ABH 2017
MODALIDADE I - HLA
DESEMPENHO GERAL POR RESOLUÇÃO

	DESEMPENHO GERAL POR ALTA RESOLUÇÃO		
	HLA -DRB1, -DQB1	HLA -A, -B, -C, -DRB1, -DQB1	HLA -A, -B, -C, -DRB1, -DQB1, -DPB1
Número de Laboratórios Inscritos	13	7	6
Número de Laboratórios Avaliados	13	7	6
Desempenho Excelente	8	4	4
Desempenho Bom	5	2	0
Desempenho Insatisfatório	0	1	2

